



# Aide à la commande

## Solutions myoélectriques de membre supérieur

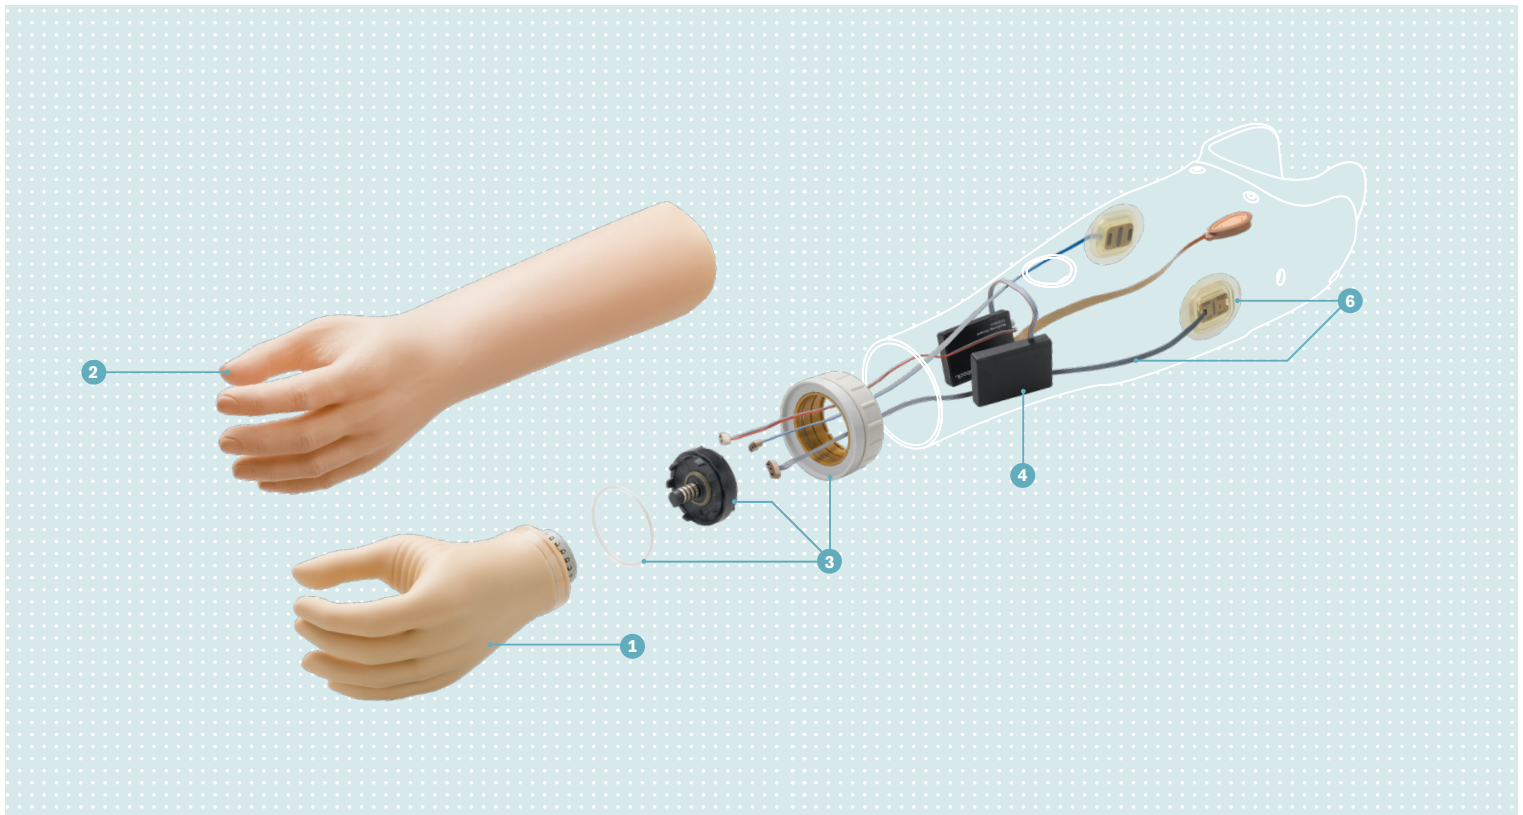

### Information produit

1	<b>Main</b>	8E38=8*	Main Sensor Speed
		8E38=9*	MyoHand VariPlus Speed
2	<b>Gant</b>	8S11N=* / 8S12N=* 8S11=* / 8S12=*	Gant PVC MyoSkin Natural Gant PVC
		3	<b>Poignet</b>
9E169	Prise coaxiale		
10S17	Moteur de pronosupination électrique		
13E205	MyoRotronic		
10S1=* 757B35=* 757L35	Bague à couler MyoEnergy Integral MyoCharge Integral		
4	<b>Batterie</b>		
		5	<b>Chargeur</b>
6	<b>Electrodes</b>		
		13E129=G*	Câble pour électrode
7	<b>CoUDE</b>	12K50	ErgoArm Electronic plus
		12K44	ErgoArm Hybrid plus

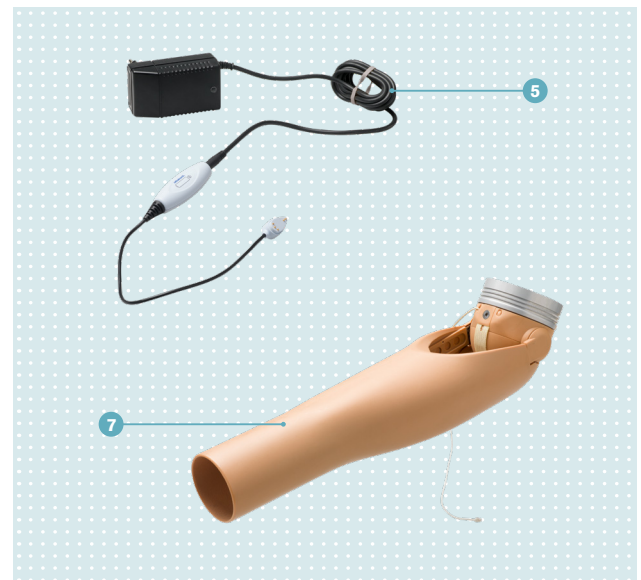

		Pronosupination active et batterie intégrée	Pronosupination passive et batterie intégrée	Pronosupination active et batterie externe	Pronosupination passive et batterie externe
<b>Moignon</b>	Court à moyen	✓	✓	✓	✓
	Long		✓		✓

# Rotation & batterie intégrées - Formulaire de commande

A retourner à votre service commercial par e-mail à : commande-ortho@ottobock.fr

Adresse de facturation		Adresse de livraison (si différente)	
N° de client	<input type="text"/>	N° commande	<input type="text"/>
Société	<input type="text"/>	Société	<input type="text"/>
Adresse	<input type="text"/>	Adresse	<input type="text"/>
	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Orthoprothésiste	<input type="text"/>		

## 1 Main

		Qté
8E38=8*	SensorHand Speed	
8E38=9*	MyoHand VariPlus Speed	
<b>Autre main :</b>		
<b>*Taille et côté :</b>		
<b>Gauche</b>	<b>Taille</b>	<b>Droit</b>
	7 ¼	
	7 ¾	
	8 ¼	

## 2 Gant

	Homme	Femme	Qté
Gant prothétique MyoSkin Natural	8S11N=*	8S12N=*	
Gant prothétique	8S11=*	8S12=*	

### Entourer la couleur de votre choix :

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18

Informations : Les gants MyoSkin Natural sont disponibles dans les couleurs 2, 4, 6, 8, 11, 14 et 16. Les gants prothétiques pour femme sont seulement disponibles pour la taille 7 1/4. Pour définir la couleur de vos gants prothétiques référez-vous au nuancier de couleurs 646M3. Pour définir la couleur de vos gants prothétiques MyoSkin Natural, référez-vous au nuancier de couleurs 646M47.

## 3 Poignet

10S4	Passif	Pièce de couplage
9E163		Prise coaxiale
10S17	Actif	Moteur de pronosupination électrique
13E205		MyoRotronic
10S1=45		Bague à couler taille 7 ¼
10S1=50		Bague à couler taille 7 ¾
10S1=54		Bague à couler taille 8 ¼ (non compatible avec Ergo Arm)
743Y.....		Gabarit bague à couler (choix selon la taille choisie en amont)

## 4 Batterie

		Qté
757B20	EnergyPack (900 mAh)	
757B21	EnergyPack (800 mAh)	
757B35=.....	MyoEnergy Integral (0, 1, 3)	

## 5 Chargeur

757L35	MyoCharge Integral
757L43	Adaptateur de charge USB

## 6 Électrodes

13E200=50	Électrode
13E202=50	Électrode étanche
13E129=G.....	Câble pour électrode (300, 600 ou 1000)

## 7 Coude pour appareillage transhuméral

12K44=45	ErgoArm Hybrid Plus pour taille de main 7 ¼
12K44=50	ErgoArm Hybrid Plus pour taille de main 7 ¾ et 8 ¼
12K50=45	ErgoArm Electronic Plus pour taille de main 7 ¼
12K50=50	ErgoArm Electronic Plus pour taille de main 7 ¾ et 8 ¼

### Accessoires (optionnels)

8E33=9-1	Greifer DMC VariPlus
OC1560=.....	Chausse prothèse TR ou TH
640F12	Spray nettoyant
640F13	Flacon nettoyant
4X74	Chargeur automobile
99B83	Gabarit
99B13=.....	Tube de raccordement en taille 16 mm ou 21 mm
616T69=.....	ThermoLyn soft, standard
616T111=.....	ThermoLyn ultra souple avec silicone en taille 9 ou 12 mm (blanc)
616T112=.....	ThermoLyn ultra souple avec silicone en taille 9 ou 12 mm (chair)

### Composants additionnels

Numéro d'article	Dénomination	Qté

Date .....

Lieu .....

Signature .....