

Manchon tibial sur mesure SiliconeGel d'après relevé de mesure

Relevé de mesure

Donneur d'ordre		Adresse de livraison (si différente de celle du donneur d'ordre)	
N° client	<input type="text"/>	N° client	<input type="text"/>
Société	<input type="text"/>	Société	<input type="text"/>
Rue	<input type="text"/>	Rue	<input type="text"/>
Code postal/ville	<input type="text"/>	Code postal/ville	<input type="text"/>
Orthoprothésiste	<input type="text"/>	Com.	<input type="text"/>

Côté concerné : Gauche Droit
 Épaisseur de paroi : 4 mm 5 mm 6 mm

Épaisseur à l'extrémité distale du moignon :


- Première commande
 Commande ultérieure, dernier numéro ML :

- 6Y70=M** Manchon SiliconeGel avec textile, avec raccord distal
- 6Y71=M** Manchon SiliconeGel avec textile, sans raccord distal (avec protection invisible)
- 6Y71=M-1** Manchon SiliconeGel avec textile, sans raccord distal (sans protection invisible)
- 6Y75=M** Manchon sur mesure TT Skinguard avec textile, avec raccord
- 6Y76=M** Manchon sur mesure TT Skinguard avec textile, sans raccord distal (avec protection invisible)
- 6Y76=M-1** Manchon sur mesure TT Skinguard avec textile, sans raccord distal (sans protection invisible)

En cas de commandes ultérieures, l'épaisseur de la paroi peut faire l'objet d'une tolérance de $\pm 10\%$.

- Bande d'extension (matrice) pour la minimisation des mouvements verticaux**
- mm : longueur de l'extrémité du moignon
 - : nombre de doigts de matrice
 - Matrice circulaire fermée

- Couleur de textile : Chair
 Gris (avec couture couleur chair)
 Technologie SKINGUARD

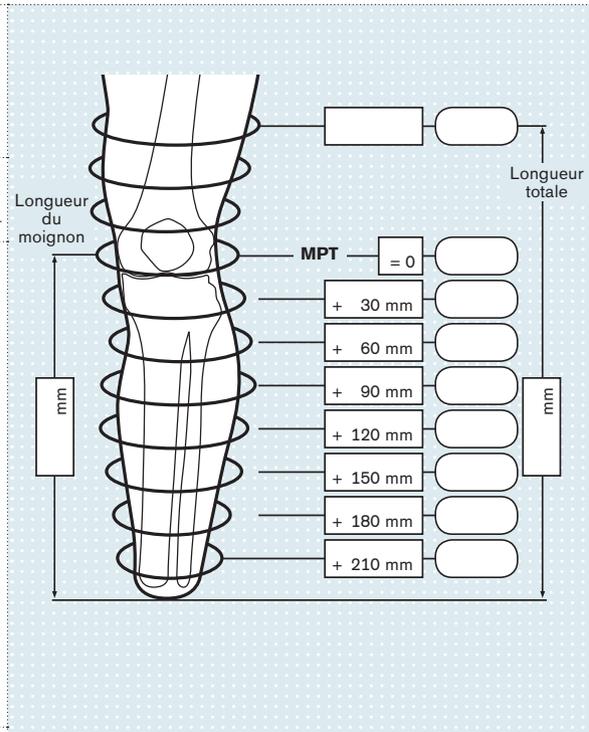

Remarques :

.....

Date Lieu Signature