

# Articulations unilatérales - Bon de commande

A retourner à votre service commercial par e-mail à : commande-ortho@ottobock.fr ou par fax au 01.69.07.18.02


Société		Date	
Technicien		Signature	
Client			

## Information patient

Numéro identifiant ..... Poids ..... Indication .....

Côté  Gauche  Droit  Bilatéral

Les tailles sélectionnées dépendent du poids du patient et des conditions d'utilisation.

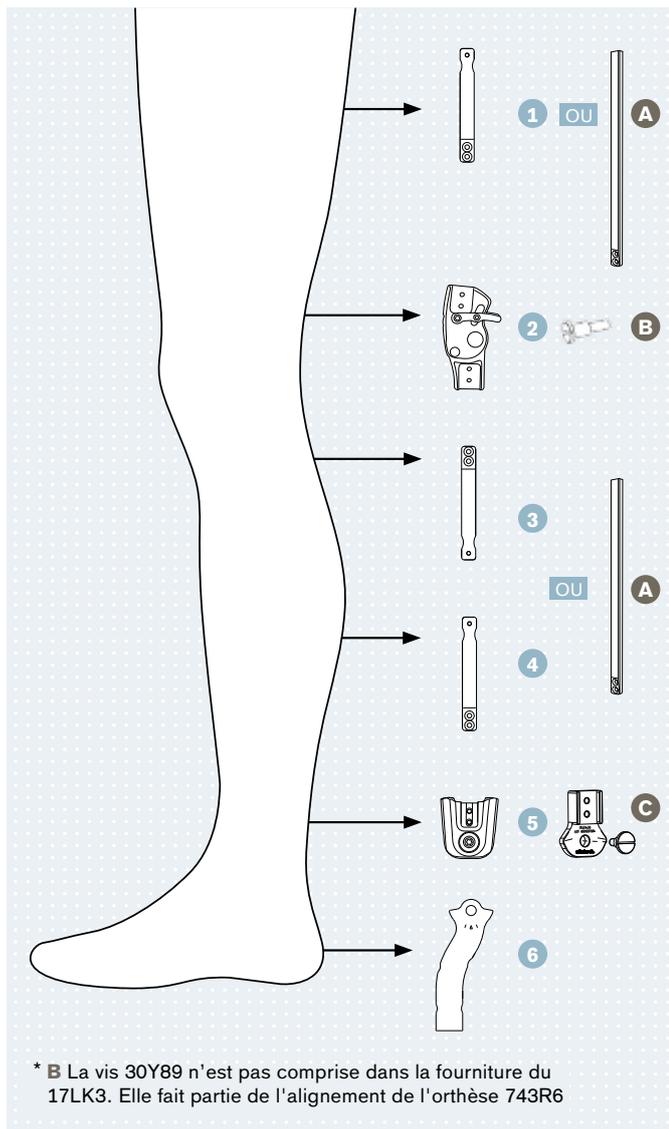

### 1 Barre de stratification 17LS3=\* OU A Barre d'extension 17LV3=\*

Version en acier	Version en titane	Version en acier
<input type="checkbox"/> 17LS3=10	<input type="checkbox"/> 17LS3=10-T	<input type="checkbox"/> 17LV3=10
<input type="checkbox"/> 17LS3=12	<input type="checkbox"/> 17LS3=12-T	<input type="checkbox"/> 17LV3=12
<input type="checkbox"/> 17LS3=14	<input type="checkbox"/> 17LS3=14-T	<input type="checkbox"/> 17LV3=14
<input type="checkbox"/> 17LS3=16	<input type="checkbox"/> 17LS3=16-T	<input type="checkbox"/> 17LV3=16
<input type="checkbox"/> 17LS3=20	<input type="checkbox"/> 17LS3=20-T	<input type="checkbox"/> 17LV3=20

### B Vis d'épaule\*

<input type="checkbox"/> 17LK3=12	<input type="checkbox"/> 17LK3=12-T	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> 30Y89
<input type="checkbox"/> 17LK3=14	<input type="checkbox"/> 17LK3=14-T	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> 30Y89
<input type="checkbox"/> 17LK3=16	<input type="checkbox"/> 17LK3=16-T	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> 30Y89
<input type="checkbox"/> 17LK3=20	<input type="checkbox"/> 17LK3=20-T	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> 30Y89

### 3, 4 Barre de stratification 17LS3=\* OU A Barre d'extension 17LV3=\*

Version en acier	Version en titane	Version en acier
<input type="checkbox"/> 17LS3=10	<input type="checkbox"/> 17LS3=10-T	<input type="checkbox"/> 17LV3=10
<input type="checkbox"/> 17LS3=12	<input type="checkbox"/> 17LS3=12-T	<input type="checkbox"/> 17LV3=12
<input type="checkbox"/> 17LS3=14	<input type="checkbox"/> 17LS3=14-T	<input type="checkbox"/> 17LV3=14
<input type="checkbox"/> 17LS3=16	<input type="checkbox"/> 17LS3=16-T	<input type="checkbox"/> 17LV3=16
<input type="checkbox"/> 17LS3=20	<input type="checkbox"/> 17LS3=20-T	<input type="checkbox"/> 17LV3=20

### 5 Articulation unilatérale de cheville 17LA3N=\*

Version en acier	Version en titane	C Gabarit de stratification avec vis d'épaule
<input type="checkbox"/> 17LA3N=10	<input type="checkbox"/> 17LA3N=10-T	<input type="checkbox"/> 17LD1N=10
<input type="checkbox"/> 17LA3N=12	<input type="checkbox"/> 17LA3N=12-T	<input type="checkbox"/> 17LD1N=12
<input type="checkbox"/> 17LA3N=14	<input type="checkbox"/> 17LA3N=14-T	<input type="checkbox"/> 17LD1N=14
<input type="checkbox"/> 17LA3N=16	<input type="checkbox"/> 17LA3N=16-T	<input type="checkbox"/> 17LD1N=16
<input type="checkbox"/> 17LA3N=20	<input type="checkbox"/> 17LA3N=20-T	<input type="checkbox"/> 17LD1N=20

### 6 Étrier (en acier) 17LF3N=\*

<input type="checkbox"/> 17LF3N=10	<input type="checkbox"/> 17LF3N=14	<input type="checkbox"/> 17LF3N=20
<input type="checkbox"/> 17LF3N=12	<input type="checkbox"/> 17LF3N=16	

\* B La vis 30Y89 n'est pas comprise dans la fourniture du 17LK3. Elle fait partie de l'alignement de l'orthèse 743R6